


## POPIS STANDARDU

- \* Mycí stůl laboratorní na umývání rukou s dvojicí dřezů a atypickou délkou pracovní desky osazený v nice.
- \* Nosná konstrukce prvku z nerezových plechů a profilů.
- \* Standardní rozměr dřezu 500 × 500 / 250 mm, zvýšený okraj, potravinářská nerez AISI 304 (ČSN 17 348) - tl. 1 mm. Dřezy jsou součástí pracovní desky atypických rozměrů - dle rozměrů na stavbě.
- \* Součástí každé z výlevků je sifon, zátka, laboratorní směšovací stojánková baterie. Osazované armatury musí být v provedení pro laboratorní prostředí (mosaz s ochrannou vrstvou epoxypolyesteru) a vyrobeny v souladu s normou DIN 12 918, závity musí odpovídat normě ISO 228/1, barevné značení dle EN 13792:2000.
- \* Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách, certifikát ČSN EN 13 150, být ve shodě s EN 14056.


## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	1700 mm
hloubka	600 mm
výška	900 mm

## PŮDORYSNÉ SCHÉMA

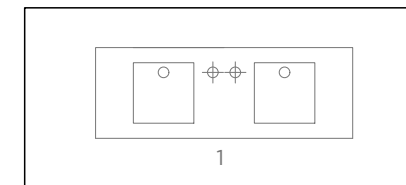

## ZOBRAZENÍ

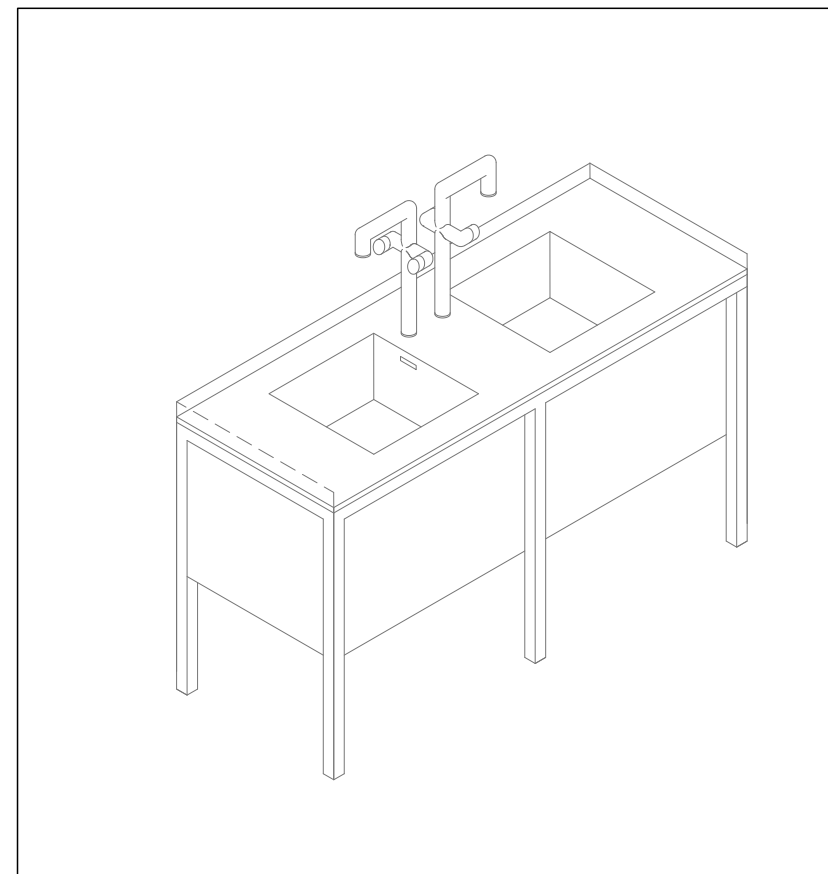

## OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

mycí stůl laboratorní - dvojdrž

01

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB G	DVD	112	01	S 001	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION