



DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 10. 11. 2011

Č.j: MU/66598/2011/RMU

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Systémy pro laserovou konfokální mikroskopii projektu CEITEC“

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 3.11.2011 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), níže uvedenou odpověď s dodatečnými informacemi.

Dotaz

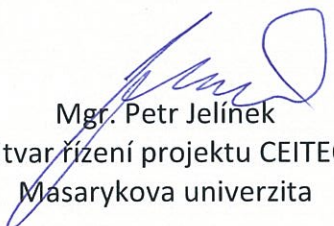
„Dobrý den.

Bude zadavatel akceptovat osvětlovací systém, který má vycentrovanou lampu ve výrobním závodě a není tedy možné centrování lampy uživatelem? Důvodem tohoto řešení je, že centrování lampy uživatelem vede ke zhoršení homogenity osvětlení. Centrování aperturní clony je možné.“

Odpověď zadavatele

Ano, pokud bude lampa vycentrována ve výrobním závodě, lampa nemusí být centrovatelná. V takovém případě však musí být informace o vycentrování lampy v závodě z nabídky dostatečně zřejmá.

S pozdravem,


Mgr. Petr Jelínek
Útvar řízení projektu CEITEC
Masarykova univerzita

MASARYKOVA UNIVERZITA
Centrální řídicí struktura projektu CEITEC
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 1