


POPIS STANDARDU

- * Mycí stůl laboratorní na umývání rukou s dřezem a atypickou délkou pracovní desky osazený v nice.
- * Nosná konstrukce prvku z nerezových plechů a profilů.
- * Standardní rozměr dřezu 500 × 500 / 250 mm, zvýšený okraj, potravinářská nerez AISI 304 (ČSN 17 348) - tl. 1 mm. Dřez je součástí pracovní desky atypických rozměrů - dle rozměrů na stavbě.
- * Součástí výlevky je sifon, zátka, laboratorní směšovací stojánková baterie. Osazovaná armatura musí být v provedení pro laboratorní prostředí (mosaz s ochrannou vrstvou epoxypolyesteru) a vyrobeny v souladu s normou DIN 12 918, závitů musí odpovídat normě ISO 228/1, barevné značení dle EN 13792:2000.
- * Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách, certifikát ČSN EN 13 150, být ve shodě s EN 14056.


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	1200 mm
hloubka	600 mm
výška	900 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

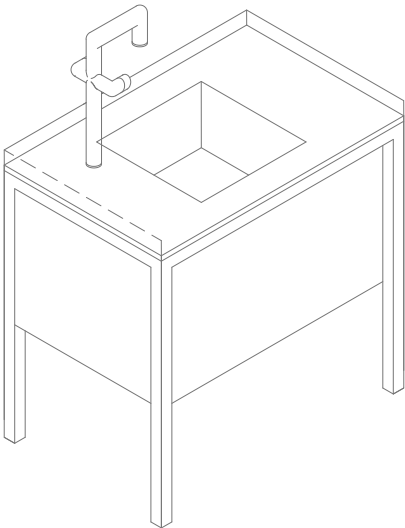

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

mycí stůl laboratorní - dřez