

Položka č. 1: Laboratorní stůl - konstrukce

Popis:


Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu 30x50 mm. Pevnost a stabilita konstrukce musí být zajištěna zadní trnoží, svislými výztuhami v bocích a vodorovnými výztuhami pod pracovní deskou. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

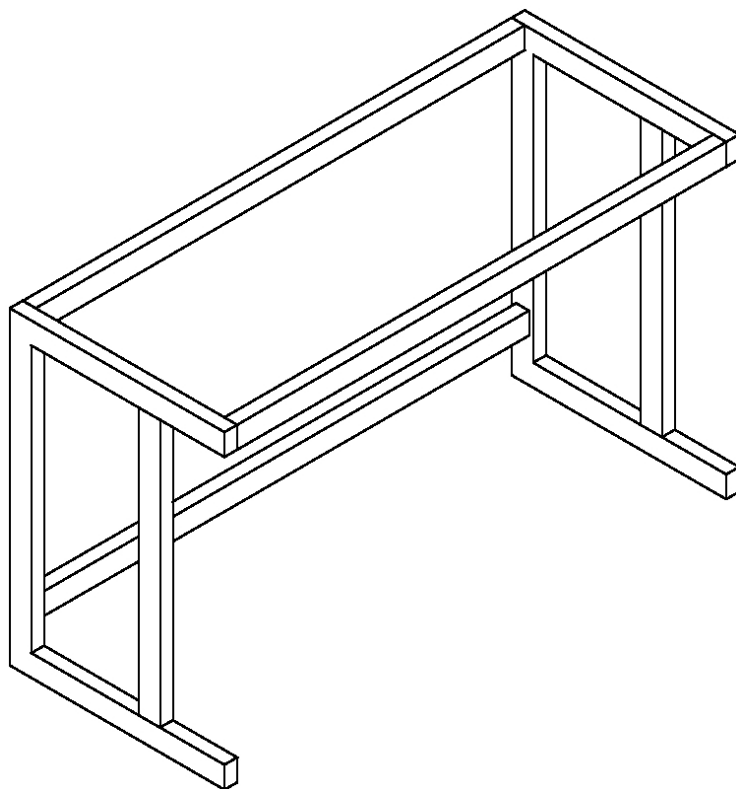

Položka č. 1: Laboratorní stůl: Pracovní deska

Popis:

Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.

Tyto pracovní desky musí splňovat základní požadavky ČSN EN 312-3 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.

Po kompletaci s konstrukcí musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:



Položka č. 2: Laboratorní židle

Popis:

Laboratorní PUR kolečková židle s pevnou konstrukcí, polyuretanový měkčený sedák a opěradlo. Výškově nastavitelný sedák plynovým perem. Stavitelná výška sedáku 440 – 580 mm. Min. rozměr sedáku š 460 x hl 440 mm s výškou min. 30 mm. Bez područek. Kolečka pogumovaná pro tvrdý povrch. Hmotnost max. 10 kg.

Vyobrazení:

